

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE INVERSION TABLE

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS AND WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

To reduce the risk of injury:

- Read and understand all the instructions, review all other accompanying documents, and inspect the equipment before using the inversion table. It is your responsibility to familiarize yourself with the proper use of this equipment and the inherent risks of inversion if these instructions are not followed, such as falling on your head or neck, pinching, entrapment, equipment failure, or aggravating a pre-existing medical condition. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of the product are fully informed about the proper use of the equipment and all safety precautions.
- **DO NOT** use the equipment without a licensed physician's approval. Carefully review the following list of medical contraindications for inversion with your licensed physician (this is not an exhaustive list, it is intended only for reference):
 - Middle ear infection
 - Extreme obesity
 - Pregnancy
 - Hiatal or ventral hernia
 - Eye conditions like glaucoma, retinal detachment or conjunctivitis
 - Chronic sinusitis
 - High blood pressure or hypertension
 - Heart or circulatory disorders
 - Use of anticoagulants (including high doses of aspirin)
 - Weakness, frailty, or mobility issues
 - Dizziness, trouble with coordination or head-down disorientation
 - Vertigo, motion sickness or inner ear disorders
 - Brain injury or recent head trauma
 - Recent stroke or transient ischemic attack
 - Spinal injury or conditions impacting the spinal cord
 - Cerebral sclerosis
 - Medical conditions associated with the weight-bearing joints
 - Acutely swollen joints
 - Bone weakness (osteoporosis)
 - Recent or unhealed fractures
 - Medullary pins or surgically implanted orthopedic supports
 - Any other medical condition that may be made more severe by an elevation of blood pressure, intracranial pressure or the mechanical stress of the inverted position
- **ALWAYS** be certain the Ankle Lock System is properly adjusted and fully engaged, and that your ankles are secure before using the equipment. HEAR, FEEL, SEE and TEST that the Ankle Lock System is snug, close-fitting and secure EVERY TIME you use the equipment.
- **ALWAYS** wear securely tied lace-up shoes with a flat sole, such as a normal tennis-style shoe.
- **DO NOT** wear any footwear that could interfere with securing the Ankle Lock System, such as shoes with thick soles, boots, high-tops or any shoe that extends above the anklebone.
- **DO NOT** use the inversion table until it is adjusted properly for your height and body weight. Improper settings can cause rapid inversion or make returning upright difficult. New users, and users who are physically or mentally compromised, will require the assistance of a spotter. Make sure the equipment is set to your unique user settings prior to each use.
- **DO NOT** sit up or raise head to return upright. Instead, bend knees and slide your body to the foot-end of the inversion table to change weight distribution. If locked out in full inversion, follow the instructions for releasing from the locked position before returning upright.
- **DO NOT** continue using the equipment if you feel pain or become light-headed or dizzy while inverting. Immediately return to the upright position for recovery and eventual dismount.
- **DO NOT** use if you are over 6 ft 6 in (198 cm) or over 300 lbs. (136 kg). Structural failure could occur or head/neck may impact the floor during inversion.
- **DO NOT** allow children to use this machine. Keep children, bystanders, and pets away from machine while in use. The inversion table is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision and instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- **DO NOT** store the inversion table upright if children are present. Fold and lay the table on the floor. **DO NOT** store outdoors.
- **DO NOT** use aggressive movements, or use weights, elastic bands, any other exercise or stretching device or non-Teeter® attachments while on the inversion table. Use the inversion table only for its intended use as described in this manual.
- **DO NOT** drop or insert any object into any opening. Keep body parts, hair, loose clothing and jewelry clear of all moving parts.
- **DO NOT** use in any commercial, rental or institutional setting. This product is intended for indoor, home-use only.
- **DO NOT** operate equipment while under the influence of drugs, alcohol, or medication that may cause drowsiness or disorientation.
- **ALWAYS** inspect the equipment prior to use. Make sure all fasteners are secure.
- **ALWAYS** replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
- **ALWAYS** position equipment on a level surface and away from water or ledges that could lead to accidental immersion or falls.
- Refer to additional warning notices posted on the equipment. If a product label or Owner's Manual should become lost, damaged or illegible, contact Customer Service for replacement.

DO NOT REMOVE. REPLACE IF DAMAGED OR REMOVED.



To download and print Teeter's 800ia™ instructions, visit the product support page at teeter.com or scan with your smartphone

Para descargar las instrucciones y de Teeter impresión 800ia™, visite la página de soporte de producto en teeter.com o escanear con su teléfono inteligente



There are four (4) User Settings on your Teeter® that must be properly adjusted for your unique needs and body type. Take time to find your ideal settings. **Every time prior to using the inversion table, make sure the User Settings are adjusted to your personal settings.**

⚠ WARNING

Failure to set these adjustments correctly may result in too rapid inversion or difficulty returning upright.

Roller Hinges: Select a Hole Setting

The Roller Hinges control the responsiveness or rate of rotation of the inversion table. There are three holes; the hole selection depends both on your body weight and the rotational responsiveness you desire (diagram right). For users just learning to use the inversion table, use the 'Beginner / Partial Inversion' setting.

Changing the Roller Hinge Setting

1. Loosen the de-rattler knob. Pull out the Height-Selector Locking Pin and slide the Main Shaft in all the way to the very last hole (the storage setting near the Rear Ankle Cups). Release and engage the Pin (Figure 1).
2. Stand in front of the Table Bed and rotate it opposite from use (Figure 2) to rest against the Crossbar of the A-Frame.
3. Grasp each Roller Hinge under the Pivot Pins, using your thumbs to open the Self-Locking Hooks over the Pivot Pins (Figure 3). Lift both sides of the Table Bed out of the A-Frame and rest the head of the Table Bed on the floor.
4. Open each Cam Lock completely. Disengage the Roller Hinge from the Bracket Pin and slide it to the desired setting (Figure 4). Engage the Bracket Pin in the same Roller Hinge hole setting on each side. Secure the Cam Lock.
5. Re-attach the Table Bed into the A-Frame Hinge Plates (Figure 5). Ensure the Self-Locking Hooks snap closed over each Roller Hinge Pivot Pin. Rotate the Table Bed to the use position and adjust the Main Shaft for use (Figure 6). Re-tighten the de-rattler knob.

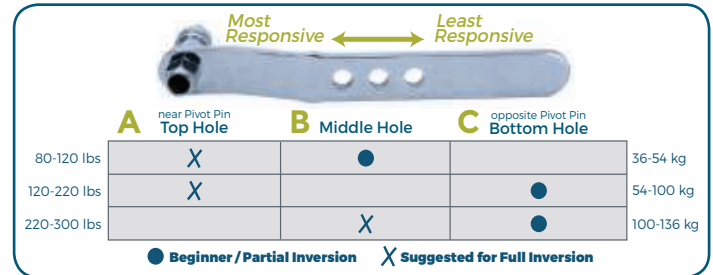


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Main Shaft: Determine a Height Setting



Figure 7
Labeled ① Set Height right on the equipment!

1. Stand on the left side of the A-Frame. Loosen the de-rattler knob. Pull out the Height-Selector Locking Pin with your right hand while sliding the Main Shaft out with your left (Figure 7). For ease of adjustment, lower the Main Shaft below horizontal to lengthen and raise the Main Shaft above horizontal to shorten.
2. Start by sliding the Main Shaft until the last setting you can read is one inch greater than your height (e.g. if you're 5'10"/178 cm, the last numbers visible will be 5'11"/180 cm). This helps to ensure that the rotation of the table is not too fast. You will test to see if this setting is right for you later. Your ideal height setting will depend on your weight distribution and could vary several inches on either side of your actual height.
3. Release the spring-loaded Height-Selector Locking Pin to fully engage a hole setting. Use caution to prevent pinching fingers. Ensure the Pin passes completely through the Main Shaft. Re-tighten the de-rattler knob.



Figure 8

Angle Tether: Pre-Set the Angle

Attach the Angle Tether to the U-Bar under the Table Bed (Figure 8) to limit the degree of rotation. Slide the buckle to lengthen or shorten the tether to pre-set your desired maximum inversion angle, or unclip the tether altogether when you are ready to rotate into full inversion.

Ankle Comfort Dial™: Find Your Setting

The Ankle Comfort Dial rotates into a High (1) or Low (2) setting (Figure 9), with a one inch height variance. Set the Ankle Comfort Dial so the Front & Rear Ankle Cups secure around the smallest part of your ankles (with minimal distance between the Ankle Lock System and the top of your foot). This will reduce body slide on the Table Bed while inverted, which can cause a shift in weight distribution and interfere with the ease of which you can control your rotation.



Figure 9

BEFORE USING THE INVERSION TABLE

Make sure the inversion table rotates smoothly to the fully inverted position and back, and that all fasteners are secure. Ensure that there is adequate clearance to rotate in front, above and behind you.

⚠ WARNING

FAILURE TO PROPERLY SECURE THE ANKLES COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH! **ALWAYS** check that the Ankle Lock System is fully engaged in a hole setting that brings the Cups to a snug, close fit against the smallest part of the ankles. **ALWAYS** wear securely tied, lace-up shoes with a flat sole, such as a tennis shoe. **DO NOT** wear shoes with thick soles, boots, high-tops or any shoe that extends above the anklebone, as this type of footwear could interfere with properly securing your ankles. **NEVER** use the inversion table face down. **DO NOT** attempt to invert or lean your upper body against the Table Bed before securing your ankles.



Figure 10



Figure 11



Figure 11A



Figure 12



Figure 13



Figure 14

Labeled **② Lock Ankles** right on the equipment!

Secure Your Ankles

Prior to inverting, properly secure your ankles by following these steps:

1. With your back to the Table Bed, and using the handles to steady yourself, carefully step inside the A-Frame to stand next to one side of the Main Shaft (the A-Frame Crossbar will be behind your legs) (Figure 10). Lift the foot closest to the Main Shaft over the Ankle Lock System and place it on the floor on the other side, to straddle the Main Shaft.
2. If the Ankle Lock System is closed, push down on the EZ-Reach Handle, then push outward to open it all the way. Release the handle in the open position.
3. To balance yourself, rest only your lower body against the lower portion of the Table Bed as you slide one ankle at a time from the side (Figure 11) between the Front & Rear Ankle Cups, placing your feet on the Ankle Comfort Dial.

Do not insert your foot into the Ankle Lock System as you would slide your foot into a shoe (Figure 11a). Your feet should always be either on the floor or on the Ankle Comfort Dial; never use any other part of the inversion table as a step.

4. Press your ankles back firmly against the Rear Ankle Cups, then slightly rotate the tops of the Cups so they are angled toward the back of your leg/Achilles tendon (Figure 12). This will allow the Cups to rotate somewhat as you invert so the cushioned part comfortably supports your ankles.
5. Push down on the EZ-Reach Handle (Figure 13), pull toward your legs and release when the Front & Rear Ankle Cups fit snug, with a close fit against the smallest part of your ankles (Figure 14). If there is too much distance between the Cups and the top of your feet, refer to [Ankle Comfort Dial: Find Your Setting](#). Jiggle the EZ-Reach Handle from front to back to make sure it has fully engaged and is locked securely. Verify that no part of your footwear or garments touch or interfere with the EZ-Reach Ankle Lock System in any way during inversion.

Employ the method of **“HEAR, FEEL, SEE, TEST”** every time you secure your ankles in the inversion table:

HEAR the locking EZ-Reach Handle click into place;

FEEL the EZ-Reach Handle to make sure it is fully engaged and locked in its setting, and **FEEL** that the Front & Rear Ankle Cups are close-fitting around the smallest part of your ankles;

SEE that the EZ-Reach Handle is secure, and does not move out of position, and **SEE** that there is NO space between your ankles and the Ankle Cups.

TEST the EZ-Reach Ankle Lock System enclosure to ensure that it is snug, close-fitting and secure by wiggling and attempting to pull your feet through the Ankle Cups. Ensure that you CANNOT disengage from the Ankle Cups each time before attempting to invert.

Testing Your Balance and Rotation Control

When adjusted properly, you will control the rotation of the inversion table by simply shifting your body weight by moving your arms or bending your knees. Your ideal balance settings are determined by your body type and weight distribution - this is why your Main Shaft setting may differ from your actual height.

It's important to take time, test your settings, and ensure a relaxing, enjoyable experience! Failure to properly adjust your height setting may result in too rapid inversion or difficulty returning upright.

Set the Angle Tether and for your first few inversion sessions, ask a spotter to assist you until you are able to find your correct balance setting and are comfortable with the operation of the inversion table.

- Lean back and rest your head on the Table Bed with your arms at your sides.
 - If balanced correctly, the inversion table should begin to rotate slightly, with the Main Shaft lifting a few inches off the bumper of the Crossbar (Figure 15).
 - The Main Shaft may be **TOO SHORT** if the inversion table rotates so that the Main Shaft lifts more than a few inches off the Crossbar, to horizontal (0°) or beyond. Carefully dismount, lengthen the height setting by one hole, secure your ankles again and re-test.
 - The Main Shaft may be **TOO LONG** if the inversion table does not rotate at all, and the Main Shaft remains seated firmly on the Crossbar. Carefully dismount, shorten the height setting by one hole, secure your ankles again and re-test.

Your Main Shaft setting should remain the same as long as you continue to use the same Roller Hinge setting and your weight does not fluctuate substantially. If you change your Roller Hinge setting, you should test your balance and control again.



Inverting

Rotating Into Inversion

To ensure the inversion table does not rotate too far, too quickly, be sure that you have attached the Angle Tether and completed the balance testing.

- With your head resting against the Table Bed, raise one arm at a time to begin rotation (Figure 16). For maximum control and comfort, every movement should be slow and deliberate (the faster you move, the faster the inversion table will rotate).
- Practice controlling the speed and angle of rotation by slowly moving your arms back and forth.
- Once you've reached the maximum angle allowed by the Angle Tether, rest both arms over your head. Relax and breathe deeply to help your muscles relax (Figure 17).



Returning Upright

- To begin rotating back to starting position, slowly bring your arms to your sides.
- Since your body may have lengthened or shifted on the Table Bed while inverted, arm movements may not be enough to return you completely upright. Simply bend your knees slightly while shifting your body weight toward the foot-end of the Table Bed (Figure 18). **DO NOT** lift your head, rely solely on the handles or try to sit up (Figure 19).
- Stop and rest for a few minutes just past horizontal (0°) to help prevent dizziness and allow your back to re-compress without discomfort before returning completely upright.

If you still have trouble returning upright after following these suggestions, adjust your User Settings and test your balance and rotation control again.



WARNING

To release from full inversion lock-out (see pg 5), reach one hand behind your head and pull the table bed toward your back. To return upright, place arms at your sides. If this does not work, **DO NOT SIT UP**. Use handles and **BEND YOUR KNEES** to shift body weight to the foot-side of the table bed. If you have difficulty returning upright, consult the 'Testing Your Balance' section.

Full Inversion

Full inversion is defined as hanging completely upside down (90°) with your back free from the Table Bed. Many Teeter® users enjoy this option because of the added freedom of movement for stretches and exercises. However, DO NOT attempt this step until you are completely comfortable controlling the rotation of the inversion table and are able to fully relax at an angle of 60°. To fully invert:

1. Disconnect the Angle Tether.
2. Adjust the Roller Hinges to Setting A to enable the inversion table to “lock” firmly in full inversion. If you are 220 lbs (100 kg) or more, set the Roller Hinges to Setting B (see User Settings, pg 2).
3. Slowly raise both hands over your head to begin rotation. You may need to assist the last few degrees of rotation by pushing on the floor or A-Frame until the Table Bed stops against the Crossbar (Figure 20).
4. Relax and allow your body to pull away from the Table Bed so you are hanging freely. If you tense up or press your back against the Table Bed, you will likely come “unlocked.”
5. In your correct balance setting, your weight will keep the Table Bed “locked” in this position until you are ready to return upright. If unable to maintain an adequate “lock” while fully inverted, contact Teeter® Customer Service for options.

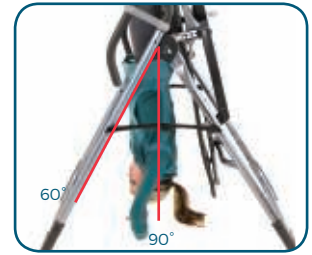


Figure 20



Figure 21

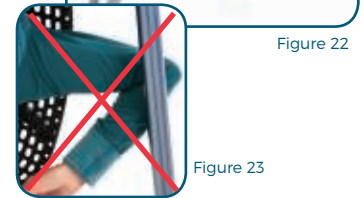


Figure 22



Figure 23

To Release from the Inverted “Locked” Position:

1. With one hand, reach behind your head and grasp the Table Bed (Figure 21). With the other hand, grasp the base of the A-Frame in front.
2. Pull both hands together (Figure 22). This will rotate the Table Bed out of the “locked” position. Keep elbows in to avoid pinching between the A-Frame and Table Bed (Figure 23). Follow the instructions for Returning Upright on the previous page.

Dismounting

1. Push down on the EZ-Reach Handle to disengage the lock, then push out to open the Ankle Lock System all the way (Figure 24).
2. Release the handle in the open position.
3. Keep your lower body supported against the Table Bed as you step onto the floor. Carefully stand up and ensure you have your balance before stepping over the Main Shaft and finishing your dismount.



Figure 24

Storage & Maintenance

Folding For Storage

1. Disconnect the Angle Tether and loosen the de-rattler knob.
2. Pull out the Height-Selector Locking Pin and slide the Main Shaft in all the way to the last hole (the storage setting near the Rear Ankle Cups). Release and engage the Pin.
3. Stand in front of the Table Bed and rotate it **opposite from use** until it rests against the Crossbar of the A-Frame (Figure 25).
4. Pull up on the Spreader Arms to fold the A-Frame (Figure 26), leaving the A-Frame legs open to a width of 16-20” for stability. Use caution to prevent pinching fingers.

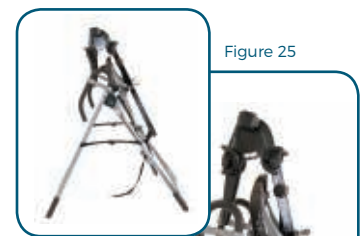


Figure 25



Figure 26

⚠ WARNING

Tipping Hazard: Leave A-Frame open wide enough to remain stable, or secure to a wall to prevent tipping. If children are present, store flat on the floor, not upright.

If you opt to leave the inversion table open and ready for use, be sure to **SECURE** the equipment to deter unintentional rotation. You can either **A.** loop the Angle Tether around the Main Shaft and Crossbar, then attach it to itself with the clip (Figure 27), or **B.** secure with a Key Lock (available to order at teeter.com). Test to ensure the inversion table cannot rotate.

Maintenance

Wipe with a damp cloth to clean. Prior to every use, check for wear and tear. Replace damaged or worn parts immediately. Keep out of service until repaired. Contact Teeter for service recommendations.



Figure 27



Get Started

Control Your Rotation: The angle and speed of rotation will greatly impact your inversion experience. To limit the angle of rotation, pre-set the Angle Tether (pg 2). To control speed or responsiveness of rotation, optimize the the Roller Hinges and Main Shaft settings for your body type (pg 2). Take time to test and adjust your settings (pg 4) with the help of a spotter until you are able to fully control the rotation of the Teeter by simply shifting the weight of your arms.

Determine the Angle: Start at a modest angle (20°-30°) for the first few weeks or until you become comfortable with the sensation and operation of the equipment. Once you are able to fully relax, advance to greater angles of inversion to increase decompression benefits. Work up to 60° (parallel with the A-frame rear legs) or beyond for best results, but be sure to advance slowly and listen to your body – relaxation is key. Many users never do more than 60°, and that's just fine! That said, some advanced users enjoy the added freedom of movement for stretches and exercises at full inversion (90°).

Determine the Duration: Begin with short 1-2 minute sessions to allow your body to adapt to inversion. Over time, as you feel comfortable, gradually work up to a duration that allows your muscles to fully relax and release so your back can decompress. This should typically take about 3-5 minutes.

Make it a Habit: Most users will find better results with shorter, more frequent sessions than longer sessions done infrequently. Ideally, work it into your routine so that you are able to invert with your Teeter several times a day.



Realize Benefits

Relax & Release: Close your eyes, take deep breaths and elongate your body. Focus on un-tensing your muscles to allow your spine and joints to decompress. The better you are able to relax, the more benefits you will feel.

Add Stretching & Movement: Intermittent Traction (alternating inversion with rest periods) or oscillation (rhythmic rocking) can help you get used to the feeling of inversion and encourage muscle relaxation. Add movement and stretching to help maximize the benefits for your joints and ligaments: gently stretch and twist while partially or fully inverted, or use the A-Frame, Traction or Grip-and-Stretch Handles to add decompression.

Give it Time: Like starting any new exercise program, it can take some time to see the results. Some people feel the benefits immediately and some take longer. Be patient, stick with it and invert often.



Maximize Comfort

Increase Ankle Comfort: Wear socks with lace-up shoes – the material will provide added cushion and support for the ankles. Adjust the Ankle Comfort Dial for minimal space between the foot and platform. Slightly rotate the top of the Rear Cups toward your ankles so they will rotate to support your heels as you invert. Secure the Ankle Lock System for a snug, close fit.

Reduce Muscle Soreness: As with any exercise program, you may experience mild soreness when you first get started. While you're relaxed, your body is making huge changes as your skeleton and muscles adapt. Don't do too much, too soon - begin with a modest angle and shorter duration to reduce the likelihood of soreness.

Listen to Your Body: Respond to any signs of discomfort by making changes: reduce the angle and/or duration, try different times of day, take deep breaths, and add gentle movement and stretching. When you feel like you've had enough, return upright! Inversion is all about relaxation and enjoyment.

Return Upright Slowly: Be sure to rest at just past horizontal (0°) for 15-30 seconds or more to allow your body to readjust and your back to gradually re-compress before dismounting the equipment.

Understand the Equipment: Watch the Getting Started DVD for more inverted stretching and exercise tips. Read and always follow the Owner's Manual. Always check that your personalized User Settings are correct before inverting, and always lock in your ankles.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA TABLA DE INVERSIÓN

⚠️ ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

Para reducir el riesgo de lesiones:

- Lea y comprenda todas las instrucciones, revise todos los documentos adjuntos e inspeccione el equipo antes de usar la tabla de inversión. Es su responsabilidad familiarizarse con el uso adecuado de este equipo y los riesgos inherentes de la inversión, como caer sobre su cabeza o cuello, pellizcarse, quedar atrapado o fallas en el equipo o agrava una afección médica preexistente. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del producto reciban información completa sobre el uso adecuado del equipo y de todas las precauciones de seguridad.
- **NO utilice el equipo sin la aprobación de un médico certificado.** Revise cuidadosamente con su médico la siguiente lista de contraindicaciones médicas para la inversión (Esta no es una lista exhaustiva; su propósito es sólo de referencia):
 - Infección del oído medio
 - Obesidad extrema
 - Embarazo
 - Hernia ventral o hiatal
 - Enfermedades de los ojos como glaucoma, desprendimiento de la retina o conjuntivitis
 - Sinusitis crónica
 - Presión sanguínea alta o hipertensión
 - Trastornos cardíacos o circulatorios
 - Uso de anticoagulantes (incluyendo dosis altas de aspirina)
 - Debilidad, fragilidad o problemas de movilidad
 - Mareos, dificultad con la coordinación o desorientación con la cabeza hacia abajo
 - Vértigo, mareo provocado por el movimiento o trastornos del oído interno
 - Lesión cerebral o trauma craneal reciente
 - Accidente cerebro-vascular o accidente isquémico transitorio reciente
 - Blessure de la colonne vertébrale o afecciones que tienen un impacto en la médula espinal.
 - Esclerosis cerebral
 - Afecciones médicas asociadas con las articulaciones que soportan el peso.
 - Inflamación articular aguda
 - Debilidad ósea (osteoporosis)
 - Fracturas recientes o que no han sanado
 - Clavos de fijación medular o soportes ortopédicos implantados quirúrgicamente
 - Cualquier otra afección médica que pueda verse agravada por un aumento en la presión arterial, presión intracraneal o el estrés mecánico de la posición invertida
- **SIEMPRE** asegúrese de que el Mecanismo de seguridad para tobillos esté debidamente ajustado y acoplado, y que sus tobillos estén asegurados antes de usar el equipo. ESCUCHE, SIENTA, VEA y PRUEBE que el mecanismo de seguridad para tobillos esté cómodo, ajustado y seguro CADA VEZ que use el equipo.
- **SIEMPRE** utilice calzado con los cordones bien ajustados y que tenga suela plana, como el calzado deportivo normal.
- **NO** use calzado que pueda interferir con el Mecanismo de seguridad para tobillos, como zapatos con suelas gruesas, botas, calzado alto ni ningún tipo de zapato que supere la altura del hueso del tobillo.
- **NO** use la tabla de inversión hasta que esté correctamente ajustada para su altura y peso corporal. El ajuste inadecuado puede causar una inversión rápida o hacer que el regreso a la posición vertical sea difícil. Los nuevos usuarios y quienes presenten impedimentos físicos o mentales requerirán la ayuda de otra persona. Asegúrese de que el equipo esté configurado para su configuración de usuario única antes de cada uso.
- **NO** se siente ni levante la cabeza para regresar a la posición vertical. En lugar doble las rodillas y deslice el cuerpo hacia el extremo de los pies de la tabla de inversión para cambiar la distribución del peso. Si se bloquea en inversión completa, siga las instrucciones para liberarlo de la posición bloqueada antes de regresarlo a la posición vertical.
- **NO** continúe usando el equipo si siente dolor o si siente mareo o vértigo al estar invertido. Regrese de inmediato a la posición vertical para recuperarse y eventualmente bajarse.
- **NO** utilice la tabla si mide más de 6 pies y 6 pulgadas (198 cm) o pesa más de 300 lbs. (136 kg). Podría producirse un fallo estructural o la cabeza/cuello podría impactar contra el suelo durante la inversión.
- **NO** permita que los niños utilicen esta máquina. Mantenga a los niños, espectadores y mascotas lejos de la máquina mientras se encuentre en uso. Esta tabla de inversión no está diseñada para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que les falta experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión e instrucción con respecto al uso de la máquina de parte de una persona responsable de su seguridad.
- **NO** guarde la tabla de inversión en posición vertical si hay niños presentes. Doble y recueste la tabla en el piso. **NO** la guarde en áreas al aire libre.
- **NO** realice movimientos agresivos ni utilice pesas, bandas elásticas ni ningún otro dispositivo de estiramiento o de ejercicio, ni accesorios que no sean de la marca Teeter® mientras se encuentre en la tabla de inversión. Utilice esta tabla de inversión solo para los fines descritos en este manual.
- **NO** deje caer ni introduzca ningún objeto en los orificios. Mantenga el cuerpo, el cabello, la ropa suelta y las joyas lejos de las piezas móviles.
- **NO** lo utilice en ningún entorno comercial, de alquiler o institucional. Este producto está diseñado sólo para el uso doméstico.
- **NO** use el equipo mientras esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos que puedan causar somnolencia o desorientación.
- **SIEMPRE** revise el equipo antes de usarlo. Revise que todos los sujetadores estén seguros.
- **SIEMPRE** reemplace las piezas defectuosas de inmediato y/o no utilice el equipo hasta que se repare.
- **SIEMPRE** coloque el equipo sobre una superficie plana y lejos del agua o cornisas que puedan provocar inmersiones o caídas accidentales.
- Consulte los avisos de advertencia adicionales colocados en el equipo. Si la etiqueta del producto o el manual del usuario se pierde, daña o no se puede leer, póngase en contacto con Servicio al cliente para reemplazarlo.

NO QUITAR. REEMPLAZAR EN CASO DE SER DAÑADO O QUITADO.



To download and print Teeter's 800ia™ instructions, visit the product support page at teeter.com or scan with your smartphone

Para descargar las instrucciones y de Teeter impresión 800ia™, visite la página de soporte de producto en teeter.com o escanear con su teléfono inteligente



Hay cuatro (4) Configuraciones de usuario en la tabla de inversión Teeter que deben ajustarse correctamente según sus necesidades y tipo de cuerpo. Tómese el tiempo para encontrar su configuración ideal. **Antes de usar la tabla de inversión, asegúrese de que la Configuración de Usuario esté ajustada a su configuración personal.**

ADVERTENCIA

El no realizar estos ajustes correctamente puede hacer que la inversión suceda demasiado rápido o que el regreso a la posición vertical sea difícil.

Bisagras deslizantes: Seleccione un Ajuste de Orificio

Las bisagras deslizantes controlan el grado de reacción o la velocidad de rotación de la tabla de inversión. Hay tres orificios. La selección del orificio depende tanto de su peso corporal como del grado de reacción de rotación que desea (ver diagrama a la derecha). Los usuarios que están comenzando a aprender a utilizar la tabla de inversión, deben usar la configuración 'Inversión para principiantes/parcial'.

Cambio de la Posición de las Bisagras Deslizantes

1. Afloje la perilla de sujeción. Tire del pasador de seguridad del regulador de altura y deslice completamente el eje principal hasta el orificio de la última posición (la posición de almacenamiento cerca de los soportes traseros para los tobillos). Suelte y enganche el pasador (Figura 1).
2. Párese frente al respaldo y gírelo hacia el lado opuesto al del uso (Figura 2) para apoyarlo contra la barra cruzada de la estructura en A.
3. Sujete cada bisagra deslizante bajo los pasadores de pivote, usando sus pulgares para abrir los ganchos de autobloqueo en los pasadores de pivote (Figura 3). Levante ambos lados del respaldo fuera de la estructura en A y apoye la cabeza del respaldo en el suelo.
4. Abra las levas de bloqueo por completo. Suelte la bisagra deslizante del pasador de soporte y deslícela a la posición deseada (Figura 4). Introduzca el pasador de soporte en el mismo ajuste de orificio de ambos lados de la bisagra deslizante. Asegure las levas de bloqueo.
5. Vuelva a colocar el respaldo en las placas de las bisagras de la estructura en A (Figura 5). Asegúrese de que los ganchos de autobloqueo se cierren automáticamente en cada pasador de pivote de bisagra deslizante. Gire el respaldo a la posición de uso y ajuste el eje principal para su uso (Figura 6). Vuelva a ajustar la perilla de sujeción.

	A <small>cerca de Pivot Pin Top Agujero</small>	B <small>Agujero Medio</small>	C <small>Opuesta Pivot Pin Agujero Inferior</small>	
80-120 lbs	X	●		36-54 kg
120-220 lbs	X		●	54-100 kg
220-300 lbs		X	●	100-136 kg

● Principiante / Inversión parcial X Sugerido para Inversión completa



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6

Eje principal: Determine una Posición de Altura



Figura 7
Etiquetado
① **Altura establecida**
directamente en el equipo

1. Póngase de pie en el lateral izquierdo de la estructura en A. Afloje la perilla de sujeción. Tire del pasador de bloqueo de selección de altura con su mano derecha mientras desliza el eje principal hacia afuera con su mano izquierda (Figura 7). Para facilitar el ajuste, baje el eje principal debajo de la posición horizontal para alargar y levante el eje principal sobre la posición horizontal para acortar.
2. Comience por deslizar el eje principal hasta que la última posición que pueda leer sea una pulgada más que su altura. Por ejemplo, si mide 5 pies con 10 pulgadas (178 cm) los últimos números visibles estarán ubicados a los 5 pies con 11 pulgadas (180 cm). This helps to ensure that the rotation of the table is not too fast. Esto ayuda a asegurar que la rotación de la tabla no sea demasiado rápida. Más tarde hará una prueba para ver si este ajuste es el adecuado para usted. La posición ideal para su altura dependerá de la distribución de su peso y puede variar varias pulgadas en ambas direcciones a partir de su altura real.
3. Libere el pasador de seguridad del regulador de altura accionado por resorte para que se acople totalmente en un ajuste de orificio. Tenga cuidado para evitar pellizcarse los dedos. Asegúrese de que el pasador atraviese el eje principal por completo. Vuelva a ajustar la perilla de sujeción.



Figura 8

Correa de Sujeción: Ajuste Previamente el ángulo

Fijar la correa de sujeción a la barra en U que se encuentra debajo del respaldo (Figura 8) para limitar el grado de rotación. Deslice la hebilla para alargar o acortar la correa para preajustar su ángulo de inversión máximo deseado, o libere la correa totalmente cuando esté listo para rotar a la inversión completa.

Cuadrante de Comodidad: Encuentre su Ajuste

El Cuadrante de comodidad para los tobillos gira a una posición alta (1) o baja (2) (Figura 9), con una diferencia de altura de una pulgada. Ajuste el Cuadrante de comodidad para los tobillos de modo tal que los soportes delanteros de los tobillos y los soportes del talón se sujeten en la parte más delgada de los tobillos (con una distancia mínima entre el Mecanismo de seguridad para tobillos y la parte superior de su pie). Esto reduce el deslizamiento del cuerpo sobre la tabla cuando está invertido, lo cual puede provocar un cambio en la distribución del peso e interferir con la facilidad para controlar su rotación.



Figura 9

ANTES DE USAR LA TABLA DE INVERSIÓN

Asegúrese de que la tabla rota suavemente y sin problemas a la posición de inversión total y vuelve a la posición normal, y revise que los sujetadores estén seguros. Asegúrese de que haya espacio suficiente para rotar al frente, encima, y detrás suyo.

⚠️ ADVERTENCIA

SI LOS TOBILLOS NO SE COLOCAN CORRECTAMENTE, SE PODRÍAN OCASIONAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE! **ALWAYS** revise que el mecanismo de seguridad para tobillos esté completamente encajado en un ajuste de orificio que adapte los soportes de manera cómoda y ajustada contra la parte más pequeña de los tobillos.. **SIEMPRE** utilice calzado con los cordones bien amarrados y de suela plana, como calzado deportivo. **NO** use zapatos con suelas gruesas, botas, calzado alto ni ningún zapato que supere la altura del hueso del tobillo, ya que este tipo de calzado podría impedir que se sujeten correctamente los tobillos. **NUNCA** use la tabla de inversión boca abajo. **NO** intente invertir ni inclinar la parte superior del cuerpo contra el respaldo antes de asegurar sus tobillos.

Cómo Asegurar los Tobillos

Sujete bien los tobillos antes de invertirse:

1. De espaldas al respaldo y usando las manijas para sujetarse, ingrese cuidadosamente dentro de la estructura en A para pararse a un lado del eje principal (la barra cruzada de la estructura en A estará detrás de sus piernas) (Figura 10). Levante el pie más cercano al eje principal sobre el Mecanismo de seguridad para tobillos y colóquelo sobre el piso al otro lado, a horcajadas sobre el eje principal.
2. Si el Mecanismo de seguridad para tobillos se encuentra cerrado, ejerza presión sobre la manija de fácil acceso (EZ Reach) y luego tire de ella para abrirla completamente. Deje la manija en la posición abierta.
3. Para balancearse, apoye sólo la parte inferior del cuerpo en la parte inferior del respaldo a medida que desliza un tobillo a la vez desde el costado (Figura 11) entre los soportes delanteros y traseros del talón, colocando los pies en el Cuadrante de comodidad para los tobillos.



Figura 10



Figura 11



Figura 11A

No coloque su pie dentro del Mecanismo de seguridad para tobillos del mismo modo en que lo colocaría dentro de un zapato (Figura 11a). Los pies siempre deben estar sobre el suelo o en el cuadrante de comodidad para los tobillos; nunca utilice otra parte de la tabla de inversión como escalón.

4. Revise que el mecanismo de seguridad para tobillos esté completamente encajado en un ajuste de orificio que adapte los soportes de manera cómoda y ajustada contra la parte más pequeña de los tobillos. Esto permitirá que los soportes roten a medida que usted los invierta de modo que la parte acolchada soporte cómodamente sus tobillos (Figura 12).
5. Empuje hacia abajo la manija de fácil acceso EZ-Reach (Figura 13), tire hacia sus piernas y suelte cuando los soportes traseros y delanteros para los tobillos estén bien ajustados, con el ajuste más apretado en la parte más angosta de sus tobillos (Figura 14). Si hay demasiada distancia entre los soportes y la parte superior de los pies, consulte el cuadrante de comodidad para los tobillos: Encuentre su ajuste. Pruebe el cierre moviendo la manija de fácil acceso hacia atrás y adelante para asegurarse de que está bien trabada y el Mecanismo de seguridad para tobillos está firmemente enganchado. Verifique que ninguna parte del zapato ni de la ropa quede en contacto o interfiera de ninguna forma con el Mecanismo de seguridad para tobillos de fácil acceso durante la inversión.



Figura 12



Figura 13



Figura 14

Etiquetado ② Soportes de Tobillos ¡directamente en el equipo!

Utilice el método de **“ESCUCHAR, SENTIR, VER, PROBAR”** cada vez que ajuste los tobillos en la tabla de inversión:

ESCUCHAR cuando la manija de fácil acceso hace clic;

SENTIR la manija de fácil acceso para asegurarse de que esté bien enganchada en el ajuste deseado, y

SIENTA que los soportes traseros y delanteros para los tobillos deben quedar ajustados, con el ajuste más apretado en la parte más angosta de sus tobillos;

VER que la manija de fácil acceso esté firme y no se mueva fuera de su posición, y **VEA** que NO haya espacio entre sus tobillos y los soportes de los tobillos.

PRUEBE el Sistema de sujeción de los tobillos EZ-Reach para asegurarse de que esté cómodo, ajustado y seguro al sacudir e intentar sacar los pies por los soportes de los tobillos. Asegúrese de NO PODER desenganjarse de los soportes para tobillos cada vez antes de intentar invertirse.

Pruebe su Control de Equilibrio y Rotación

Si está correctamente ajustado, tendrá control total sobre la rotación de la tabla de inversión con solo desplazar el peso de su cuerpo moviendo los brazos o inclinando las rodillas. La configuración ideal de equilibrio se determina por su tipo de cuerpo y la distribución del peso. Por esta razón, la posición del eje principal puede diferir de su altura real.

Es importante tomarse un tiempo, probar los ajustes y asegurarse una experiencia relajante y agradable. Si la altura no se ajusta correctamente, eso puede hacer que la inversión suceda demasiado rápido o que el regreso a la posición vertical sea difícil.

Las primeras veces que utilice la tabla de inversión, ajuste la correa de sujeción y pídale a otra persona que lo ayude para que pueda encontrar la posición correcta de equilibrio y para que esté cómodo con el funcionamiento de la tabla de inversión.

1. Recuéstese y apoye la cabeza sobre el respaldo con los brazos a los costados.

- Si está correctamente equilibrada, la tabla de inversión comenzará a girar levemente, con el eje principal elevándose unas cuantas pulgadas del protector de la barra cruzada (Figura 15).
- El eje principal puede ser DEMASIADO CORTO si la tabla de inversión gira de modo tal que el eje principal se eleva a más de unas cuantas pulgadas de la barra cruzada, hasta una posición horizontal (0°) o más. Desmonte con cuidado, alargue la posición de altura un orificio, sujete los tobillos de nuevo y vuelva a probar.
- El eje principal puede estar DEMASIADO LARGO si la tabla de inversión no gira en absoluto y el eje principal queda firmemente asentado en la barra cruzada. Desmonte con cuidado, acorte la posición de altura un orificio, sujete sus tobillos de nuevo y pruebe otra vez.



La configuración del eje principal debería mantenerse igual, siempre que siga utilizando la misma posición de bisagra deslizante y su peso no varíe sustancialmente. Si cambia el ajuste de la bisagra deslizante, debería probar su equilibrio y control otra vez.

Inversión

Rotación hacia la Inversión

Para asegurarse de que la tabla de inversión no rote demasiado ni muy rápido, asegúrese de haber ajustado la correa de sujeción y de haber completado la prueba de equilibrio.

1. Con la cabeza apoyada contra el respaldo, levante un brazo por vez para comenzar la rotación (Figura 16). Para obtener el máximo control y comodidad, cada movimiento debe ser lento y deliberado (cuanto más rápido se mueva, más rápido rotará la tabla de inversión).
2. Practique el control de la velocidad y el ángulo de rotación moviendo lentamente los brazos hacia atrás y hacia adelante.
3. Una vez que haya alcanzado el ángulo máximo permitido por la correa de sujeción, descance ambos brazos sobre su cabeza. Relájese y respire profundamente para ayudar a relajar sus músculos (Figura 17).



Volver a la Posición Vertical

1. Para empezar a rotar de nuevo a la posición inicial, lleve lentamente los brazos a los costados.
2. Dado que su cuerpo puede haberse extendido o deslizado sobre el respaldo mientras ha estado invertido, puede que los movimientos de los brazos no sean suficientes para volver a la posición completamente vertical. Sólo doble ligeramente las rodillas mientras lleva el peso de su cuerpo hacia la parte inferior del respaldo (Figura 18). **NO** levante la cabeza, dependa solamente de las manijas ni trate de sentarse (Figura 19).
3. Deténgase y descance durante algunos minutos apenas pasada la posición horizontal (0°) para evitar mareos y permitir que su espalda se recomprima sin molestias antes de volver a la posición vertical.

Si todavía tiene problemas para regresar a la posición vertical después de seguir estas recomendaciones, ajuste las configuraciones de usuario y pruebe otra vez el control de equilibrio y de rotación.



⚠️ ADVERTENCIA

Para liberarse de la posición de bloqueo en inversión total (consulte la página 5), coloque una mano detrás de la cabeza y jale el respaldo hacia su espalda. Para regresar a la posición vertical, coloque los brazos a los lados. Si esto no funciona, **NO SE SIENTE**. Use las manijas para **DOBLAR SUS RODILLAS** y cambiar el peso del cuerpo al lado de los pies de la tabla. Si tiene dificultad para regresar a la posición vertical, consulte la sección "Pruebe su control".

Inversión Completa

La inversión completa se define como quedar colgando completamente boca abajo (90°) con la espalda sin apoyar en el respaldo. Muchos usuarios de Teeter® disfrutan de la inversión completa debido a la libertad agregada para estirar y ejercitar. NO intente este paso hasta que no se sienta completamente cómodo controlando la rotación de la tabla de inversión e invirtiéndose a 60 grados de manera relajada. Para invertirse por completo:

1. Libere la correa de sujeción.
2. Ajuste las bisagras deslizantes a la posición A para permitir que la tabla de inversión se “bloquee” con firmeza en la inversión total. Si pesa 220 lb. (100 kg.) o más, coloque las bisagras deslizantes en la posición B (vea las Configuraciones del usuario, pág. 2).
3. Suba ambas manos lentamente por encima de la cabeza para iniciar la rotación. Tal vez deba ayudarse para alcanzar los últimos grados de rotación, empujándose contra el suelo o la estructura en A hasta que el respaldo se detenga contra la barra cruzada (Figura 20).
4. Relájese y permita que su cuerpo se aleje del respaldo para colgar libremente. Si se tensa o presiona la espalda contra el respaldo, es posible que se “desbloquee”.
5. En su posición correcta de equilibrio, su peso mantendrá el respaldo “bloqueado” en esta posición hasta que esté listo para regresar a la posición vertical. Si no logra mantener un “bloqueo” adecuado cuando está completamente invertido, llame a Servicio al cliente de Teeter® para conocer opciones.

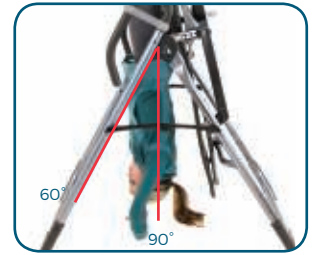


Figura 20



Figura 21

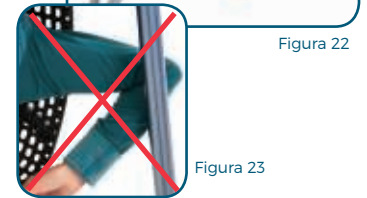


Figura 22



Figura 23

Para liberarse de la posición invertida “bloqueada”:

1. Estire un brazo por detrás de la cabeza para asirse al respaldo (Figura 21). Con la otra mano, tome la base de la estructura en A que se encuentra enfrente.
2. Junte ambas manos (Figura 22). Esto hará que el respaldo rote y se libere de la posición de “bloqueo”. Mantenga los codos hacia adentro para evitar pellizcos entre la estructura en A y el respaldo (Figura 23). Siga las instrucciones en la página anterior para volver a la posición vertical.

Desmontaje

1. Ejercer presión sobre la manija de fácil acceso para desbloquear y, luego, tire para abrir completamente el Mecanismo de seguridad para tobillos hasta el fondo (Figura 24).
2. Deje la manija en la posición abierta.
3. Mantenga la parte inferior del cuerpo apoyada contra el respaldo mientras pone los pies en el suelo. Con cuidado, póngase de pie y asegúrese de tener equilibrio antes de pasar por encima del eje principal y terminar de desmontar.



Figura 24

Almacenamiento y Mantenimiento

Pliegue para el Almacenamiento

1. Libere la correa de sujeción. Afloje la perilla de sujeción.
2. Tire del pasador de seguridad del regulador de altura y deslice completamente el eje principal hasta el último orificio (la posición de almacenamiento cerca de los soportes traseros para los tobillos). Suelte y enganche el pasador.
3. Párese frente al respaldo y gírelo en dirección opuesta a su uso hasta que se apoye sobre la barra cruzada de la estructura A (Figura 25).
4. Tire de los brazos extensibles para plegar la estructura en A (Figura 26), la cual debe quedar con las patas abiertas a 16-20° de ancho para brindar estabilidad. Tenga cuidado para evitar pellizcarse los dedos.

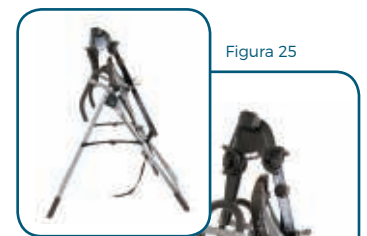


Figura 25



Figura 26

⚠️ ADVERTENCIA

Peligro de vuelco: Deje la estructura en A abierta con el ancho suficiente para que permanezca estable o sujétela a una pared para evitar que se vuelque. Si hay niños presentes, almacene en forma plana sobre el piso, no en posición vertical.

Si opta por dejar la tabla de inversión abierta y lista para usar, asegúrese de FIJAR el equipo para impedir la rotación no intencional. Puede elegir entre A. Enrollar la correa de sujeción alrededor del eje principal y la barra cruzada y luego amarrarla a sí misma con el clip (Figura 27), o B. Bloquearla con un candado (disponible en teeter.com). Asegúrese de que la tabla de inversión no pueda rotar.

Mantenimiento

Limpie con un paño limpio. Antes de cada uso, revise si hay desgaste y daños. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas de inmediato. Mantenga fuera de servicio hasta repararla. Comuníquese con Teeter para conocer las recomendaciones de servicio.



Figura 27



Para Iniciar

Controle su Rotación: El ángulo y la velocidad de rotación afectan en gran medida su experiencia de inversión. Para limitar el ángulo de rotación, ajuste previamente el ángulo (Pág. 2). Para controlar la velocidad y la respuesta de rotación, optimice los ajustes de las bisagras deslizantes y el eje principal para su tipo de cuerpo (Pág. 2). Tómese el tiempo para probar y ajustar su configuración (pág. 4) con la ayuda de una persona adicional que lo acompañe hasta que usted pueda controlar por completo la rotación del Teeter por medio de simplemente mover el peso de los brazos.

Determine el ángulo: Comience con un ángulo modesto (20° a 30°) durante las primeras semanas o hasta encontrarse cómodo con la sensación y operación del equipo. Cuando pueda relajarse por completo, pase a ángulos de inversión más amplios para aumentar los beneficios de la descompresión. Aumente hasta 60° o más para obtener los mejores resultados, pero asegúrese de ir despacio y escuchar a su cuerpo; la relajación es clave. La rotación hasta la inversión completa (90°) no es necesaria para beneficiarse de la inversión. Dicho eso, algunos usuarios avanzados disfrutaron de la libertad adicional de movimientos de estiramientos y ejercicios en este ángulo.

Determine la Duración: Comience con sesiones cortas de 1 a 2 minutos para permitir que su cuerpo se adapte a la inversión. Con el tiempo, y en la medida en que se sienta cómodo, aumente gradualmente hasta una duración que le permita relajar y liberar sus músculos por completo para que pueda descomprimir su espalda. Por lo regular esto toma de 3 a 5 minutos.

Conviértalo en un Hábito: La mayoría de los usuarios obtienen mejores resultados con sesiones más cortas y más frecuentes que con sesiones más largas y menos frecuentes. Idealmente, incorpórelo en su rutina para que pueda invertirse con su Teeter varias veces al día.



Disfrute de los Beneficios

Relajación y Liberación: Cierre los ojos, respire profundo y elongue el cuerpo. Enfóquese en liberar tensión de sus músculos para permitir que su columna y articulaciones se descompriman. Cuanto más se relaje, mayores serán los beneficios que sentirá.

Agregue Estiramiento y Movimiento: La tracción intermitente (alternar la inversión con períodos de descanso) o la oscilación (balanceo rítmico) le pueden ayudar a acostumbrarse a la sensación de inversión y estimular la relajación muscular. Agregue movimiento y estiramiento para ayudar a maximizar los beneficios para sus articulaciones y ligamentos: haga ejercicios de estiramiento y torsión mientras está parcial o totalmente invertido o utilice la estructura en A, o las empuñaduras de tracción o de Grip-and-Stretch para aumentar la descompresión.

No se Apresure: Al igual que cuando comienza cualquier nuevo programa de ejercicios, puede llevar un tiempo para que vea resultados notables. Algunas personas sienten los beneficios inmediatamente, y en algunas toma más tiempo. Sea paciente, persistente y use la tabla a menudo.



Maximice el Confort

Aumente el confort de los tobillos: Use calcetines y zapatos con cordones. La tela proporciona protección adicional y apoyo a los tobillos. Ajuste el Cuadrante de comodidad para los tobillos para que quede un espacio mínimo entre el pie y la plataforma. Rote ligeramente la parte superior de los soportes de los talones hacia sus tobillos para que roten y le den soporte a los talones cuando esté invertido. Ajuste el Mecanismo de seguridad para tobillos lo suficiente como para que esté sujeto, pero no lo ajuste demasiado ya que eso restringe el flujo sanguíneo y causa molestias.

Reduzca el dolor muscular: Al igual que con cualquier programa de ejercicios, puede ser que experimente un poco de dolor al inicio. Mientras está relajado, su cuerpo realiza cambios significativos a medida que su esqueleto y sus músculos se adaptan. No haga demasiado, ni demasiado pronto: comience con un ángulo modesto y poco tiempo para reducir la probabilidad de quedar adolorido.

Escuche a su cuerpo: Responda a cualquier señal de incomodidad por medio de cambios: reduzca el ángulo o la duración, pruebe diferentes horarios del día, respire profundo, y agregue movimientos suaves y estiramiento. Cuando sienta que ya fue suficiente, ¡regrese a la posición vertical! La inversión es para relajarse y disfrutar.

Regrese despacio a la posición vertical: Asegúrese de descansar justo después de pasar la posición horizontal (0°) por 15-30 segundos o más para permitir que el cuerpo se reajuste y que la espalda se recomprima gradualmente antes de bajarse del equipo.

Entienda el equipo: Vea el DVD introductorio para conocer más consejos de estiramiento y ejercicios invertidos. Lea el Manual del usuario y respételo siempre. Siempre verifique que su Configuración del usuario personalizada sea la correcta antes de invertirse, y siempre sujete bien sus tobillos.